機械器具 36 医療用ピンセット
一般医療機器　歯科治療用ピンセット　31814000

ブラケットホルダー

【禁忌・禁止】

ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある医療関係者、及び患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

本品は２つの先細の逆バネ性先端部を持ち、把持し、押すことにより、先端が開く。先端に歯列矯正用ブラケットを保持し、押していた手を緩めると先端が閉じ、再度押すまでブラケットを保持できる。先端の形状の違いにより以下の３種類の製品から構成される。

1）ＥＴＭ100 ダイレクトボンド　ブラケットホルダー
ツイン、シングル全てのブラケットに対応する。
製品番号：800-1005（1 個入り）、800-1007（6 個入り）

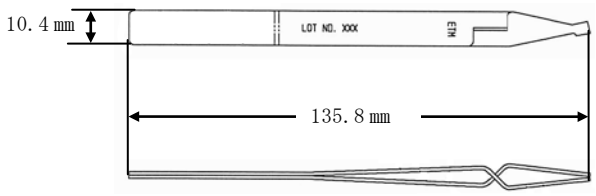

2）ＥＴＭ800Ｓダイレクトボンド　カーブドホルダー
ラビアル、リンガルいずれのブラケットにも対応する。
製品番号：800-8000

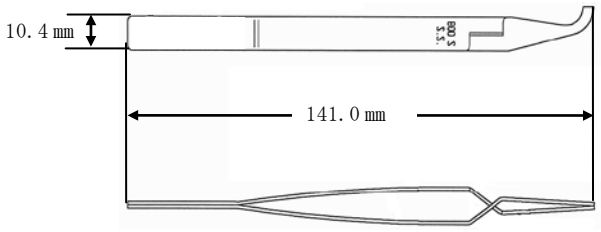

3）ＡＥＺダイレクトボンド　ブラケットホルダー
先端が鋸歯状に滑り止め加工がされている
製品番号：803-0175

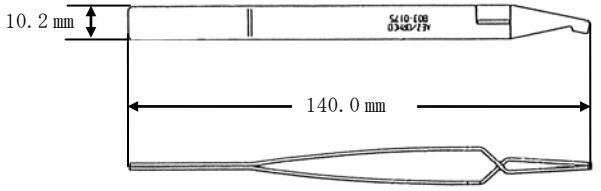

原材料：ステンレス鋼

【使用目的、効能又は効果】

歯列矯正用ブラケットを保持するために用いる歯科手用器具である。

【操作方法又は使用方法等】

1. 保持するブラケットに対応するホルダーを選択する。
2. ホルダーを把持し、押してホルダー先端部を開き、ブラケットを保持する。

【使用上の注意】

1. 本製品は【使用目的、効能又は効果】記載以外の用途には使用しないこと。
2. 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後の点検
破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
2. 洗浄・滅菌
a. オートクレーブ（高圧蒸気滅菌）
1）　使用後は、ｐＨ中性の防錆洗浄液で、精製水を用いて速やかに洗浄する。
2）　無包装でトレイの上に平らに置く。
3）　135℃、3 分間滅菌サイクルを実施する。
b. 乾熱滅菌
1）　使用後は、ｐＨ中性の防錆洗浄液で、精製水を用いて速やかに洗浄する。
2）　無包装でラックの上に平らに置く。
3）　190℃、20 分間滅菌サイクルを実施する。

［保守・点検に関する注意事項］
1. 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
2. トレイに置くときには器具と器具が触れないようにすること。
3. 本製品の滅菌は、高圧蒸気滅菌あるいは乾熱滅菌を行い、低温滅菌（ガス滅菌等）は金属素材に影響を及ぼすことがあるので、行わないこと。
4. 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。

【包装】

P/N 800-1005	ETM ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ	1 個入
P/N 800-1007	ETM ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ	6 個入
P/N 800-8000	ETM800S ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ ｶｰﾌﾞﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ	1 個入
P/N 803-0175	AEZ ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ	1 個入

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者氏名　：カボデンタルシステムズジャパン株式会社
住所　：〒581-0067 大阪府八尾市神武町 2 番 24 号
日本通運株式会社 天王寺支店
メディカルセンター内
電話番号　：072-947-2022
製造業者　：オームコ社（Ormco Corporation）
国名　：アメリカ（U.S.A.）